BiogenLab
Genel Laboratuvar Hizmetleri

i·sens
Sensing Ahead, Caring More

CareSens® H Beat

Kan Şekeri İzleme Sistemi

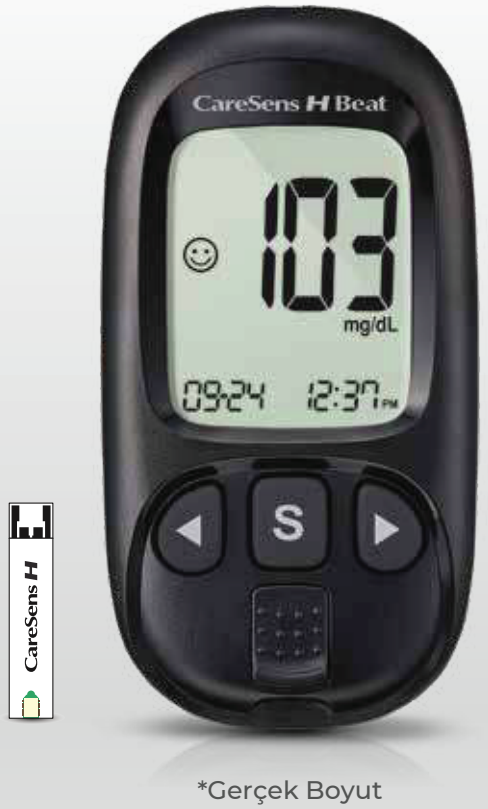

*Gerçek Boyut

Geliştirilmiş Özellikler ve Kanıtlanmış Doğruluk

·Sezgisel simgelerle görüntüleme
·Taze kapiller / Venöz / Yenidoğan / Atardamar bütün kanı



Teknik Özellikler

·0,5 µL / 5 saniye
·10-600 mg/dL (0,6-33,3 mmol/L)
·Hematokrit: %15-70
·1.000 test sonucu hafızası
·5-45 °C (41-113 °F)

Özellikler

·Kodlama gerekli değildir
·Şerit dışarı atma düğmesi
·Normal aralık, Hipoglisemi / Hiperglisemi göstergesi
·Şeritson kullanma tarihi göstergesi
·Bip sesi açık/kapalı işlevi
·4 alarm (PP2* ve 3 zaman ayarlı alarm)
*Yemekten 2 saat sonra
·1, 7, 14, 30, 90 günlük test ortalamaları
·Ön yemek, Yemek sonrası, Açlık, İşaretli bayrak yoklama
·Veri bağlantı noktası

BiogenLab, I-Sens® ürünlerinin Türkiye'deki tek yetkili distribütörüdür.

+90 (530) 696 80 03
+90 (530) 415 46 75
www.biogenlab.org
one@biogenlab.org

BiogenLab
Genel Laboratuvar Hizmetleri

i·sens
Sensing Ahead, Caring More

BiogenLab, I-Sens® ürünlerinin
Türkiye'deki tek yetkili distribütörüdür.

Kolay Diyabet Bakımı:
Daha az iş ve daha az endişe ile CareSens® H Beat

Bir adımda Operasyon

•Kodlama yok: Çubuğu takın ve tek adımda teste hazır olun.

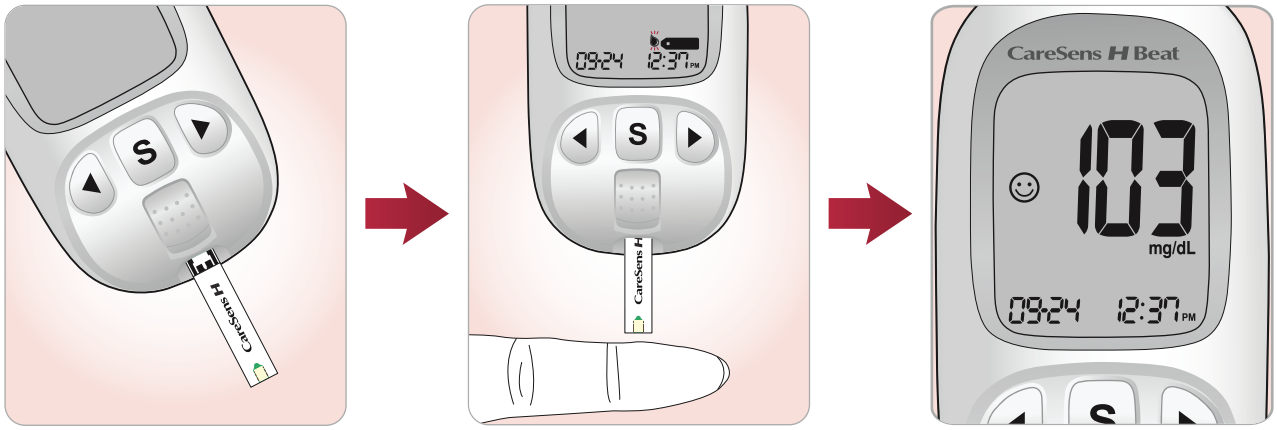

1 Test şeridini takın
2 Kan örneğini uygulayın
3 Sonuç 5 saniyede

Sezgisel Sembollerle Sınır Göstergesi

•Sembol görüntüleriyle önceden belirlenmiş aralıklar üzerinden test sonuçlarını belirleyin.
•Her göstergenin istenen aralığı özelleştirilebilir.



YÜKSEK
Hiperglisemi Göstergesi

ARALIKTA
Normal aralık Göstergesi

DÜŞÜK
Hipoglisemi Göstergesi

Geliştirilmiş Ölçüm Performansı

•Gelişmiş doğruluk
- Sonuçların %98.7'si ±15 mg/dL içinde veya referans sonuçlarının %15'i, ISO 15197:2013(EN ISO 15197:2015) doğruluk kriterlerini karşılar.

±5 mg/dL içinde veya ±5 %	±10 mg/dL içinde veya ±10 %	±15 mg/dL arasında veya ±15 %
431/600 (71.8 %)	571/600 (95.2 %)	592/600 (98.7 %)

[Konsensüs Hata Izgarası] (N=600, 3 Lot)

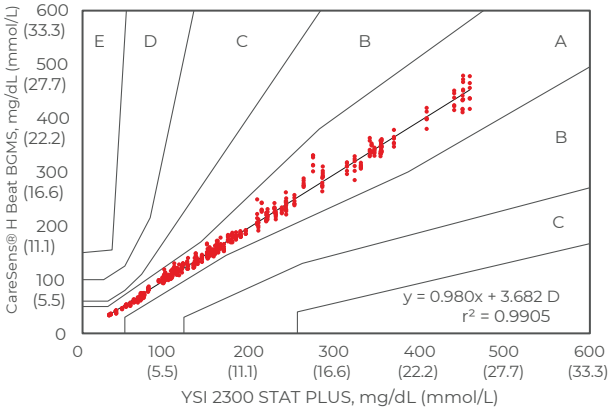

+90 (530) 696 80 03
+90 (530) 415 46 75
www.biogenlab.org
one@biogenlab.org